

# 이진영상을 이용한 워터마킹 기법

임현진 · 이승규 · 김태호 · 박무훈

창원대학교

## The Watermarking Method Using by Binary Image

Hyun-jin Lim · Seung-kyu Lee · Tea-ho Kim · Mu-hun Park

Changwon National University

E-mail : kinglhj@lycos.co.kr

### 요 약

컴퓨터의 발달과 의료기기의 디지털화로 인해 의료영상 분야도 디지털화되었다. 그 결과 디지털 의료영상의 불법복제, 소유권 및 데이터 인증 문제 또한 발생하고 있다. 이러한 환경 하에서 환자의 사생활 보호와 의료영상 자체의 소유권, 재산권의 여부 및 데이터 변형 여부의 판별을 위하여 디지털 워터마킹이 사용되고 있다. 기존에 제안된 여러 가지 워터마킹 기법들은 Non-Blind 방식에서는 원 영상이 필요하다는 점과 Blind 방식을 사용할 경우에는 육안으로는 식별이 힘든 양극 워터마크를 사용한다는 단점이 있다.

본 논문은 Blind 워터마킹에서 양극 워터마크를 삽입하는 방식을 따르지 않고, 시각적으로 인지하기 쉽도록 하기 위하여 이진 워터마크 영상을 다중 웨이블릿 변환하고, 원 영상을 이산 푸리에 변환하여 영상의 중간 주파수대에 Circular Input 방식을 이용하여 워터마크를 삽입하는 알고리즘을 제안하였고 그 방법은 상관도 0.97이라는 우수한 결과를 얻었다.

### ABSTRACT

The field of medical images has been digitalized as the development of computer and the digitalization of the medical instruments. As a result it causes a lot of problems such as an illegal copy related to medical images and property right of the medical images. Therefore, digital watermarking is used for discrimination whether the data are modified or not. It is also used to protect both the property right of medical images and the private life of many patients. The proposed theories, the Non-blind and the Blind method, have two problems. One is needed an original image and the other is using a gaussian watermarking.

This paper proposes the new Blind Watermarking using binary images in order to easily recognize the results of watermark. This algorithm is described that an watermark of a binary image is wavelet-transformed, and then a transformed watermark is inserted in medium-band of frequency domains of original image by the Circular Input method. The propose method presented the good performance of over 0.97 in NC.

### 키워드

The Blind Watermarking, Wavelet, Binary image, The Circular Input method

## I. 서 론

세계 각국의 정보화사업과 기업의 경쟁력 강화 차원에서 많은 부분의 정보들이 디지털화되어 있으며, 지금도 정보의 디지털화가 진행 중에 있어 2006년도까지 컨텐츠의 60% 이상이 디지털화 될 것으로 예측되고 있다. 이러한 환경은 디지털 저작물이 원본의 손상 없이 무제한의 복제와 유통이 가능하고 원본과의 구별이 불가능하여 저작권의 보호나 불법 복제 및 유통의 방지 등이 더욱 필요하게 되었다[1].

이러한 현상들은 일반적인 멀티미디어 컨텐츠

뿐만 아니라 의료영상의 디지털화로 인하여 의료 분야에서도 발생하고 있다.

컴퓨터를 이용하여 다양한 업무가 처리되는 사회구조 속에서 전자·정보·통신분야의 발전으로 의료장비 및 의료관리 체계에도 많은 변화가 있다.

일례로 기존의 RIS(Radiology Information System), HIS(Hospital Information System)를 확장한 PACS(Picture Archiving and Communication System)가 많은 의료기관에 보급되고 있다[2].

PACS 환경 하에서의 디지털화 된 의료영상은 필름영상에 비해 비용, 획득, 전송, 복사, 저장의 편리성과 효율성을 동시에 가지며 그로 인하여

인터넷을 기반으로 하는 의료영상 시스템, 환자정보의 원격지 전송, 데이터베이스를 이용한 교육 및 정보 이용의 활용을 가능하게 하고 있다[3].

결국 이러한 과정으로 의료영상과 데이터들이 디지털화 되면 멀티미디어 컨텐츠와 동일한 보안상의 문제점이 발생하게 된다.

일반적으로 워터마킹 방식을 나누는 여러 가지 분류 중에 Non-Blind 방식과 Blind 방식이 있다.

Non-Blind 방식은 워터마크를 추출할 시 원 영상을 필요로 하는 방식이고, Blind 방식은 워터마크 추출 시 원 영상을 필요로 하지 않는 방식이다. Non-Blind 방식은 추출시의 시간이 오래 걸린다는 단점이 있으나 구현이 간단하고 이진영상 등 시각적으로 인지하기 쉬운 영상을 이용한 워터마킹이 유용하나, Blind 방식은 추출시의 시간은 상대적으로 적게 걸리나 구현이 어렵고 이진 영상을 사용하기에 어려움이 있어 주로 Gaussian 잡음을 이용한 양극 워터마크를 삽입하여 시각적 인지성이 떨어진다는 단점이 있다.

Blind 방식에서 시각적 인지성을 높이기 위해 이진 영상을 사용하고 의사 원본 영상과의 비교를 통해 워터마크를 추출하는 방식도 제안되었다. 이방식은 워터마크의 위치를 방지할 수는 있지만 의사 원본 영상과 비교를 하는 과정에서 워터마크의 데이터에 손실을 일으킬 수 있으므로 선명한 워터마크 영상을 얻을 수 없다[4][5][6][7].

본 논문은 Blind 워터마킹에서 양극 워터마크를 삽입하는 방식을 따르지 않고, 워터마크의 손실을 없애고 시각적으로 인지하기 쉽도록 하기 위하여 이진 워터마크 영상을 다중 웨이블릿 변환하고, 원 영상을 이산 푸리에 변환하여 영상의 중간 주파수대에 Circular Input 방식을 이용하여 워터마크를 삽입함으로서 보다 선명한 워터마크 영상을 추출할 수 있는 알고리즘을 제안한다.

## II. 이론

웨이블릿 변환과 이산 푸리에 변환, Circular Input 방식은 다음과 같다.

### 2.1 웨이블릿 변환

분리성(Separability), 스케일링(Scalability), 이동성(Translatability) 커널들을 아래의 각각 수평, 수직, 대각선 웨이블릿이라고 부르는 세 개의 분리 가능한 2-D 웨이블릿들과 하나의 분리 가능한 2-D 스케일링 함수로 나타낼 수 있다[8].

수식은 다음과 같다.

$$\psi^H(x, y) = \psi(x)\phi(y) \quad (1)$$

$$\psi^V(x, y) = \phi(x)\psi(y) \quad (2)$$

$$\psi^D(x, y) = \psi(x)\psi(y) \quad (3)$$

$$\phi(x, y) = \phi(x)\phi(y) \quad (4)$$

웨이블릿 변환에서 하나의 기저함수를 웨이블

릿이라 부르며, 웨이블릿은 하나의 대역통과 필터이다. 웨이블릿은 유한 길이를 가지는 기저함수 이므로, 웨이블릿 변환은 모 웨이블릿(Mother Wavelet)이라 불리는 원형 웨이블릿의 수축과 팽창에 의해 얻어지는 웨이블릿들의 집합에 의해 구성된다.

$$W(\text{scale}, \text{position}) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\psi(\text{scale}, \text{position})dt \quad (5)$$

(5)식에 의하면 Signal  $f(t)$ 와 Mother wavelet의 Shift, Scaling을 통해 형성된 Daughter wavelet과의 합을 모든 시간에 대해 적분한 것으로 나타낼 수 있다.

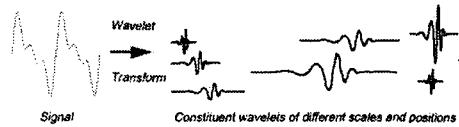


그림 4. 다른 Scale과 Position의 Wavelet들

영상에서의 웨이블릿 변환은 영상을 분할하기 위해 수평, 수직 방향으로 저대역 통과 필터와 고대역 통과 필터를 통과하여 다운샘플링(Down Sampling)되며, 크기가 다른 부밴드들을 얻을 수 있게 된다[9].

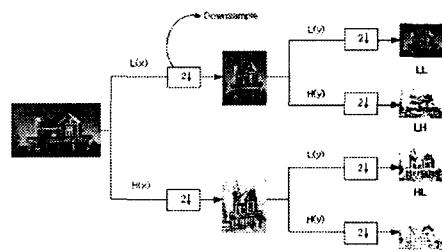


그림 2. 1단계 Wavelet 분할 및 예

### 2.2 이산 푸리에 변환

$I(x, y)$ 의 8비트 화소의 강도를 가지는  $N \times M$ 크기의 그레이 영상에서 이산 푸리에 변환은 식(6)과 같다.

$$F(u, v) = \frac{1}{N} \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{M-1} I(x, y) e^{-\frac{j2\pi ux}{N}} e^{-\frac{j2\pi vy}{M}} \quad (6)$$

영상에 대한 이산 푸리에 변환은 진폭과 위상 성분으로 나뉘며, 영상을 이산 푸리에 변환한 결과는 아래 그림3과 같다.



그림 3. 512×512 영상의 이산푸리에 변환

### 2.3 Circular Input 방식

일반적으로 영상의 주파수영역에서 외부의 공격에 강인한 부분, 즉 데이터의 부분적 손실이 이루어져도 영상에 크게 영향을 미치지 않는 부분은 중간 주파수대이다[4].

기존의 방식과 같이 영상화소에 곱하거나 더하는 방식이 아닌 시각적으로 인지할 수 없을 정도의 영상손실을 가져오면서 그보다 더 큰 워터마크 영상의 이득을 가져오기 위해 중간주파수 대에 웨이블릿 변환된 워터마크 데이터를 원형 부채살 모양으로 원 영상의 화소와 직접 1대 1교환을 하는 방식을 사용하였다.

도식적으로 나타내면 그림 4와 같다.

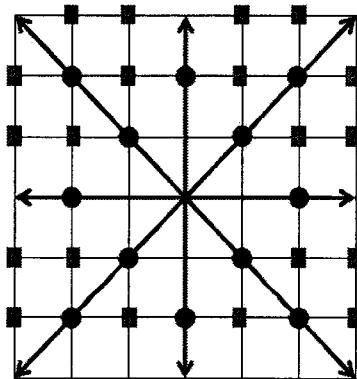


그림 4. Circular Input 방식

검출방식은 삽입방식의 역순으로 행하였으며 이진영상을 사용하였으므로 임계값 등의 특징을 사용하지 않고도 육안으로 식별가능 하므로 특정적인 유사도 값은 명시하지 않았다.

### III. 실험 및 고찰

512×512의 일반영상과 의료영상을 사용하여 2.1 - 2.3까지의 변환과 삽입방식을 따른다. 각각 32×32 및 256×256의 이진영상을 워터마크로 사용하였으며, 원 영상과 워터마크 삽입 후의 영상 그리고 추출된 워터마크 순으로 결과를 나타내었다.




그림 5 워터마크

먼저 32×32의 워터마크 영상을 512×512의 일반 영상에 넣었을 시의 그림 6의 결과영상을 얻었다.

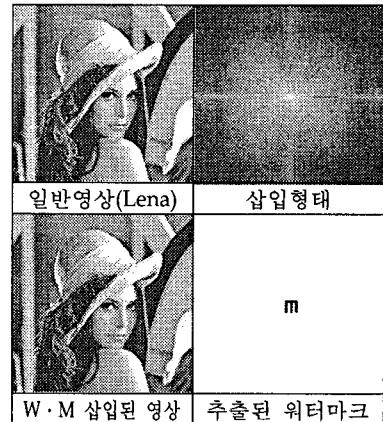


그림 6. 32×32 삽입 결과

그림 7은 32×32의 워터마크 영상을 512×512의 의료영像에 넣었을 시의 결과영상이고, 그림 8은 256×256의 워터마크 영상을 512×512의 일반영상에 넣었을 시의 결과영상이다.

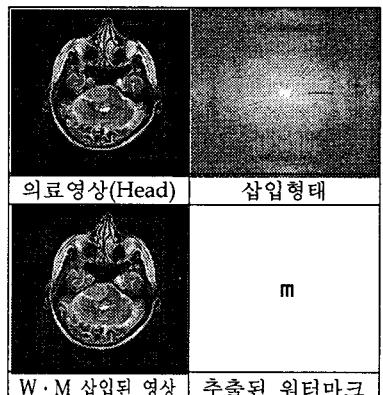


그림 7. 32×32 삽입 결과

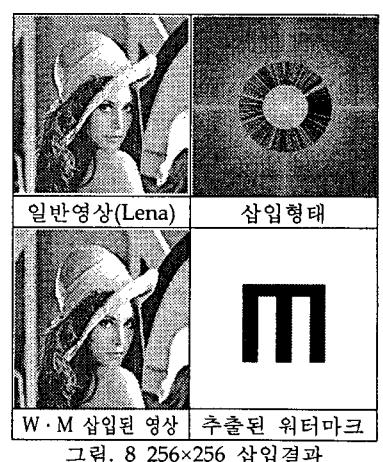


그림 8. 256×256 삽입 결과

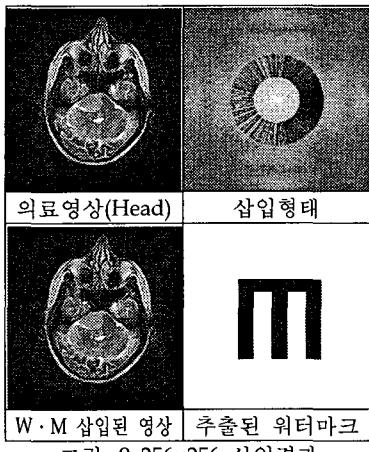


그림. 9 256×256 삽입결과

마지막으로 그림 9는 256×256의 워터마크 영상을 512×512의 의료영상에 넣었을 시의 결과영상이다.

워터마킹 영상의 화질을 알아보기 위하여 식(7)의 PSNR(dB)의 값을 실험영상에 대하여 산출해 보았다.

$$PSNR = 10 \log_{10} \left( \frac{MN(255)^2}{\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} (O(m,n) - W(m,n))^2} \right) \quad (7)$$

$O(m,n)$  : Original Image,  $W(m,n)$  : Watermarked Image

표 1은 일반영상과 의료영상에 대한 PSNR의 값을 나타내고 있다.

표 1. PSNR 값

일반영상(Lena)	의료영상(Head)
32×32	256×256
48.67dB	37.48dB

32×32의 이진 워터마크영상을 삽입한 경우 일반 영상에서 48.67dB, 의료영상에서는 47.48dB의 높은 PSNR 값을 얻을 수 있었으며, 또한 256×256의 이진 워터마크영상을 삽입한 경우에도 일반영상에서 37.48dB, 의료영상에서 31.62dB 이라는 높은 PSNR 값을 얻을 수 있었다.

실험결과에서 나타난 것처럼 다양한 크기의 워터마크 영상을 원 영상에 삽입하였음에도 불구하고, 원 영상과 워터마크가 삽입된 영상의 차이를 육안으로 쉽게 구별 할 수 없음을 알 수 있다.

또한, 각각의 추출된 워터마크 영상과 원 워터마크 영상은 0.97이상의 상관도를 보였다.

#### IV. 결 론

최근 개인용 컴퓨터의 보급 확대와 디지털 시

대를 맞이하여 다양한 디지털 저작물들이 나오고 있으며, 인터넷의 발달로 멀티미디어 데이터양이 급격히 늘어가고 있다.

본 논문에서는 PACS 환경이나 멀티미디어 컨텐츠에서 발생되는 저작권 문제를 해결하기 위하여 인지하기 쉬운 이진영상을 이용한 새로운 워터마킹 방법을 제안하였다.

본 논문은 Blind 워터마킹에서 양극 워터마크를 삽입하는 방식을 따르지 않고, 워터마크의 손실을 없애고 시각적으로 인지하기 쉽도록 하기 위하여 이진 워터마크 영상을 다중 웨이블릿 변환하고, 원 영상을 이산 푸리에 변환하여 영상의 중간 주파수대에 Circular Input 방식을 이용하여 워터마크를 삽입하는 알고리즘을 제안하였다.

워터마크의 검출방식은 삽입방식의 역순으로 행하였으며, 이진영상을 사용하였으므로 임계 값 등의 특징을 사용하지 않고도 육안으로 식별 가능하므로 특정적인 유사도 값은 명시하지 않았다.

실험결과에서 보다시피 다양한 크기의 워터마크 영상을 원 영상에 삽입하였음에도 불구하고 원 영상과 워터마크가 삽입된 영상의 차이를 육안으로 구별 할 수 없음을 알 수 있었고, 또한 각각 추출된 워터마크 영상과 원 워터마크 영상을 비교해 볼 때 전혀 차이를 느낄 수 없음을 알 수 있었다.

향후 본 논문에서 제안한 워터마킹 방식을 의료영상에도 적용하여 연구할 예정이며, 각종 공격에 관한 강인성을 가질 수 있는 변환과의 연계성에 대해서도 연구할 예정이다. 또한 이진영상 뿐만 아니라 그레이레벨의 영상을 입력하거나 짜여진 영상이 아닌 인간의 손으로 작성한 서명이나 사진 등의 영상도 워터마크로 활용하는 방법을 연구하고자 한다.

#### 참고문헌

- [1] 강상익, ITA저널, 제 73호, p. 138-144 (2000)
- [2] C.Coatrieux, H.Maitre, B.Sankur, Y.Rolland, R.Colloré, IEEE EMBS Conf. On Information (2000)
- [3] 남기철, 박무훈, 한국해양정보통신학회 춘계종합 학술발표 논문집, 7권1호, p. 255 (2003)
- [4] 남기철, 창원대학교 석사학위논문 (2003)
- [5] 김원겸, 이종찬, 이원돈, 정보처리 논문지, 7권12호, p. 3885-3897 (2000)
- [6] 배기혁, 한국 정보처리학회 춘계학술발표 논문집, 제 8권 1호 (2001)
- [7] Ingemar J. Cox, Joe Kilian, Tom Leighton, Talal Shamoon, IEEE International conference on Image Processing(ICIP 96) (1996)
- [8] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins, ITC, p257-260 (2004)
- [9] 정성환, 이문호 공저, JAVA를 이용한 디지털 영상처리, 정의사 (2005)