

1. 血腫(Hematoma)

主로 局所麻酔時 血管이 損傷을 받아 組織內로 血液이 滲出되어 tumor-like mass를 惹起시키는 것을 말한다.

〈原因〉

1) posterior superior alveolar nerve block時 posterior superior alveolar artery 및 pterygoid plexus of vein이 貫通된 境遇(그림 1)

2) inferior alveolar nerve block時 inferior alveolar artery를 貫通한 境遇(그림 2)

〈問題點〉

1) trismus나 疼痛을 惹起함.

2) 浮腫이나 變色을 惹起함.

〈處置〉

1) 麻酔中 혹은 麻酔後 即時 나타나면 出血部位에 直接壓迫

2) large needle로서 aspiration施行.

3) 처음 24hrs동안 冷濕布, 그 다음에는 温濕布를 施行한다.

4) 動脈出血인 境遇 動脈結紮을 施行한다.

5) bleeding control後 proteolytic enzyme을 投與.

6) Z & D.

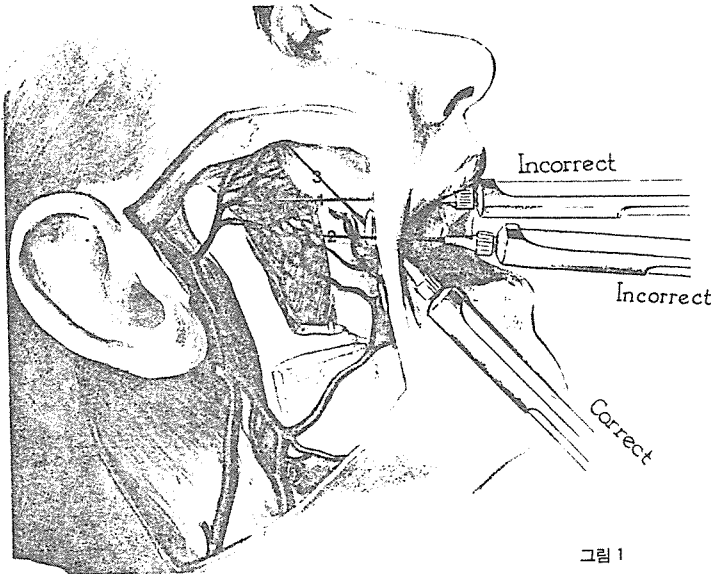


그림 1

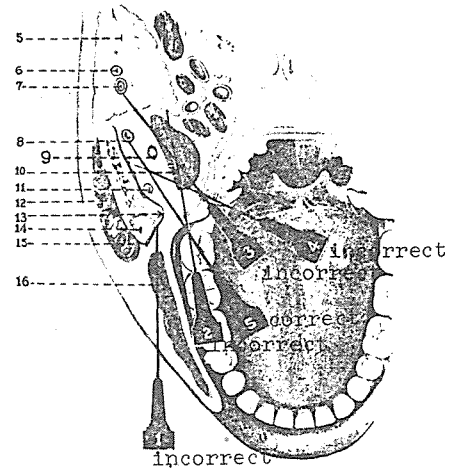



그림 2 | Anatomy: 5. Parotid gland. 6. Facial nerve. 7. Posterior facial vein. 8. Inferior alveolar artery. 9. Inferior alveolar nerve. 10. Internal pterygoid muscle. 11. Lingual nerve. 12. Masseter muscle. 13. Internal oblique ridge. 14. Ascending ramus. 15. External oblique ridge. 16. Buccinator muscle.



# SUCTION

- ① 가볍고 移動하기 쉬우며 기름칠을 할 必要가 없다.
- ② 眞空計를 읽기 쉬우며 調節손잡이로 眞空度를 0에서 22Hg까지 쉽게 調節할 수 있으며 排泄物이 흘러 넘지 않게 安全트레이가 달려 있다.
- ③ 녹과 腐蝕을 防止하기 위하여 Alcorite 皮膜을 內혀 놓았다.
- ④ Thomas社가 만든 本 Suction은 醫療機器標準(規格)에 合格한 精巧한 製品이다.

110 Volt.  
[Portable model]



**株式會社 多木洋行**  
DAMOK INTERNATIONAL LTD.  
TEL. 28-7919-778-3028